

ブローイングカトレーニング装置

# ブローイング トレーナー BT2018

息を吐く力(ブローイング力)を音と圧力で見える化。  
リハビリ効果の確認、ブローイングのトレーニングに。



口唇閉鎖が弱い方でもくわえやすい  
「小さなマウスピース」を採用




NEW Spec

## 特 徴

- ブローイングの力を数値で表示
- 数値に応じて段階的に音に変化
- 持ち運び可能なコンパクトサイズ

「肺炎後の患者でも、楽しみながら継続して  
使えるブローイングのトレーニング装置が欲しい！」  
そんな現場の声に応じて開発！

## システム構成

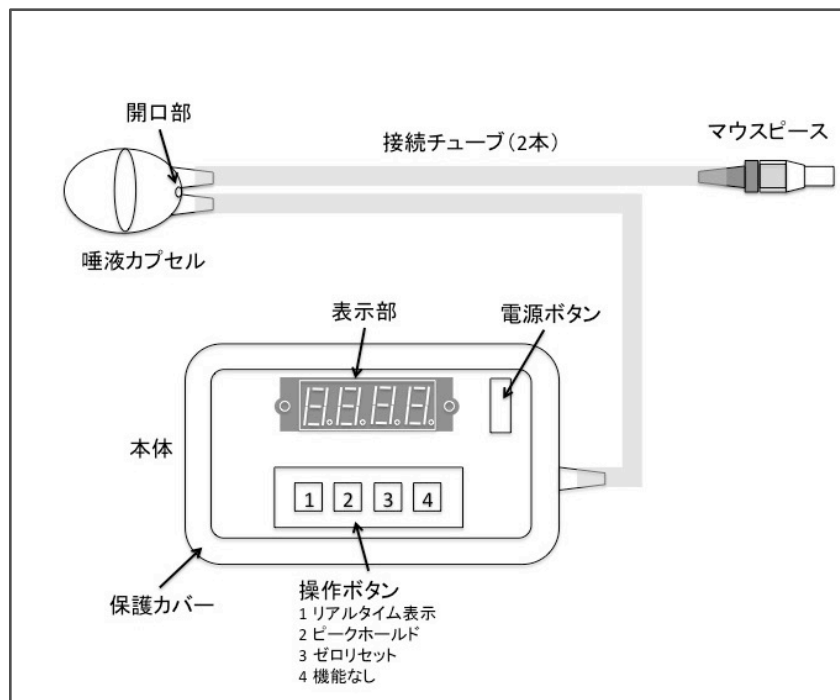

部品名称	説明
本体	呼気力（ブローイング力）を圧力で表示。保護カバーを外すと本体裏に電池ボックスがある。電池はユーザーが交換可能（9V角形電池使用）
電源ボタン	本体の電源をON/OFFする。
表示部	圧力をhPa（ヘクトパスカル）で表示する。
操作ボタン	各ボタンには以下の機能がある。 1. リアルタイム表示 2. ピークホールド表示 3. ゼロリセット 4. 機能なし
マウスピース	接続チューブと接続する。口に加え、息を吹くことで呼気圧（ブローイング圧）を測定する。
唾液カプセル	呼気時に出た唾液を貯める。
開口部	呼気時の吐く息を逃す穴。持続して吹き続けることでリハビリ用途にも使える。
接続チューブ	唾液カプセルと本体、マウスピースを接続。

## Q&A

Q: 肺活量を測定しているのですか？

A: 肺活量ではなく、息を吐く際の圧力を表示しています。単位はhPa（ヘクトパスカル）です。

Q: 洗浄はできますか？

A: マウスピースと付属チューブは洗浄可能です。本体は洗浄できません。

Q: 電池駆動ですか？

A: DC9V角型電池を一本使用しています。

Q: 本体の重さは？

A: 本体の重さは約280gです。（電池含む）

Q: 本体は防水仕様ですか？

A: シリコン性のカバーが付属していますが、防水ではありません。

Q: なぜ、音が出るのですか？

A: 楽しみながらリハビリを行うための工夫です。息を吐く圧力によって異なる音が出るようになっています。

## 開発ストーリー

ブローイングトレーナーは『肺炎で入院した患者のブローイングのトレーニングを意識高く、継続させたい！』そんな医療現場の声から生まれました。

肺炎で入院した患者は、吐く息の力が弱く、吹き戻し等の玩具を吹くトレーニングが難しい。一方でティッシュを把持して息を吹きかけるようなトレーニングでは単調すぎて継続しない。そんな現場での課題を解決すべく、開発しました。

リハビリでの使用はもちろん、健康教室や介護施設での健康維持目的でも活用が期待されています。

### 1. 使用上の注意

本製品は非医療機器です。リハビリ等で使用する場合は、有識者の指示にしたがって使用してください。

### 2. 使用目的

本製品は、呼吸機能の呼気力（ブローイング力）を数値化するブローイングトレーニング装置です。マウスピースと接続された圧力センサーで呼気時の圧力を数値で表示します。単位はhPa（ヘクトパスカル）です。

### 3. 付属品

本体：1個、接続チューブ：2本、唾液カプセル：1セット、マウスピース

製造販売元：リプト株式会社

東京都八王子市明神町4-9-1-301

TEL : 042-649-3491 / FAX : 042-649-3492

カスタマー・サポートセンター

お問い合わせ 042-649-3491